

«Медоборудование»

67700, Одесская обл., г. Б-Днестровский, ул. Шабская 102-Б

тел. 8(04849) 3-19-34, www.sterilizator.od.ua

E-mail : medoborudovanie06@ya.ua


medoborudovanie06@rambler.ru

Стерилизаторы воздушные

ГП-10-01, ГП-20-01, ГП-40-01, ГП-80-01

ТУ У 33.1-32132564-001-2003

(Руководство по эксплуатации)

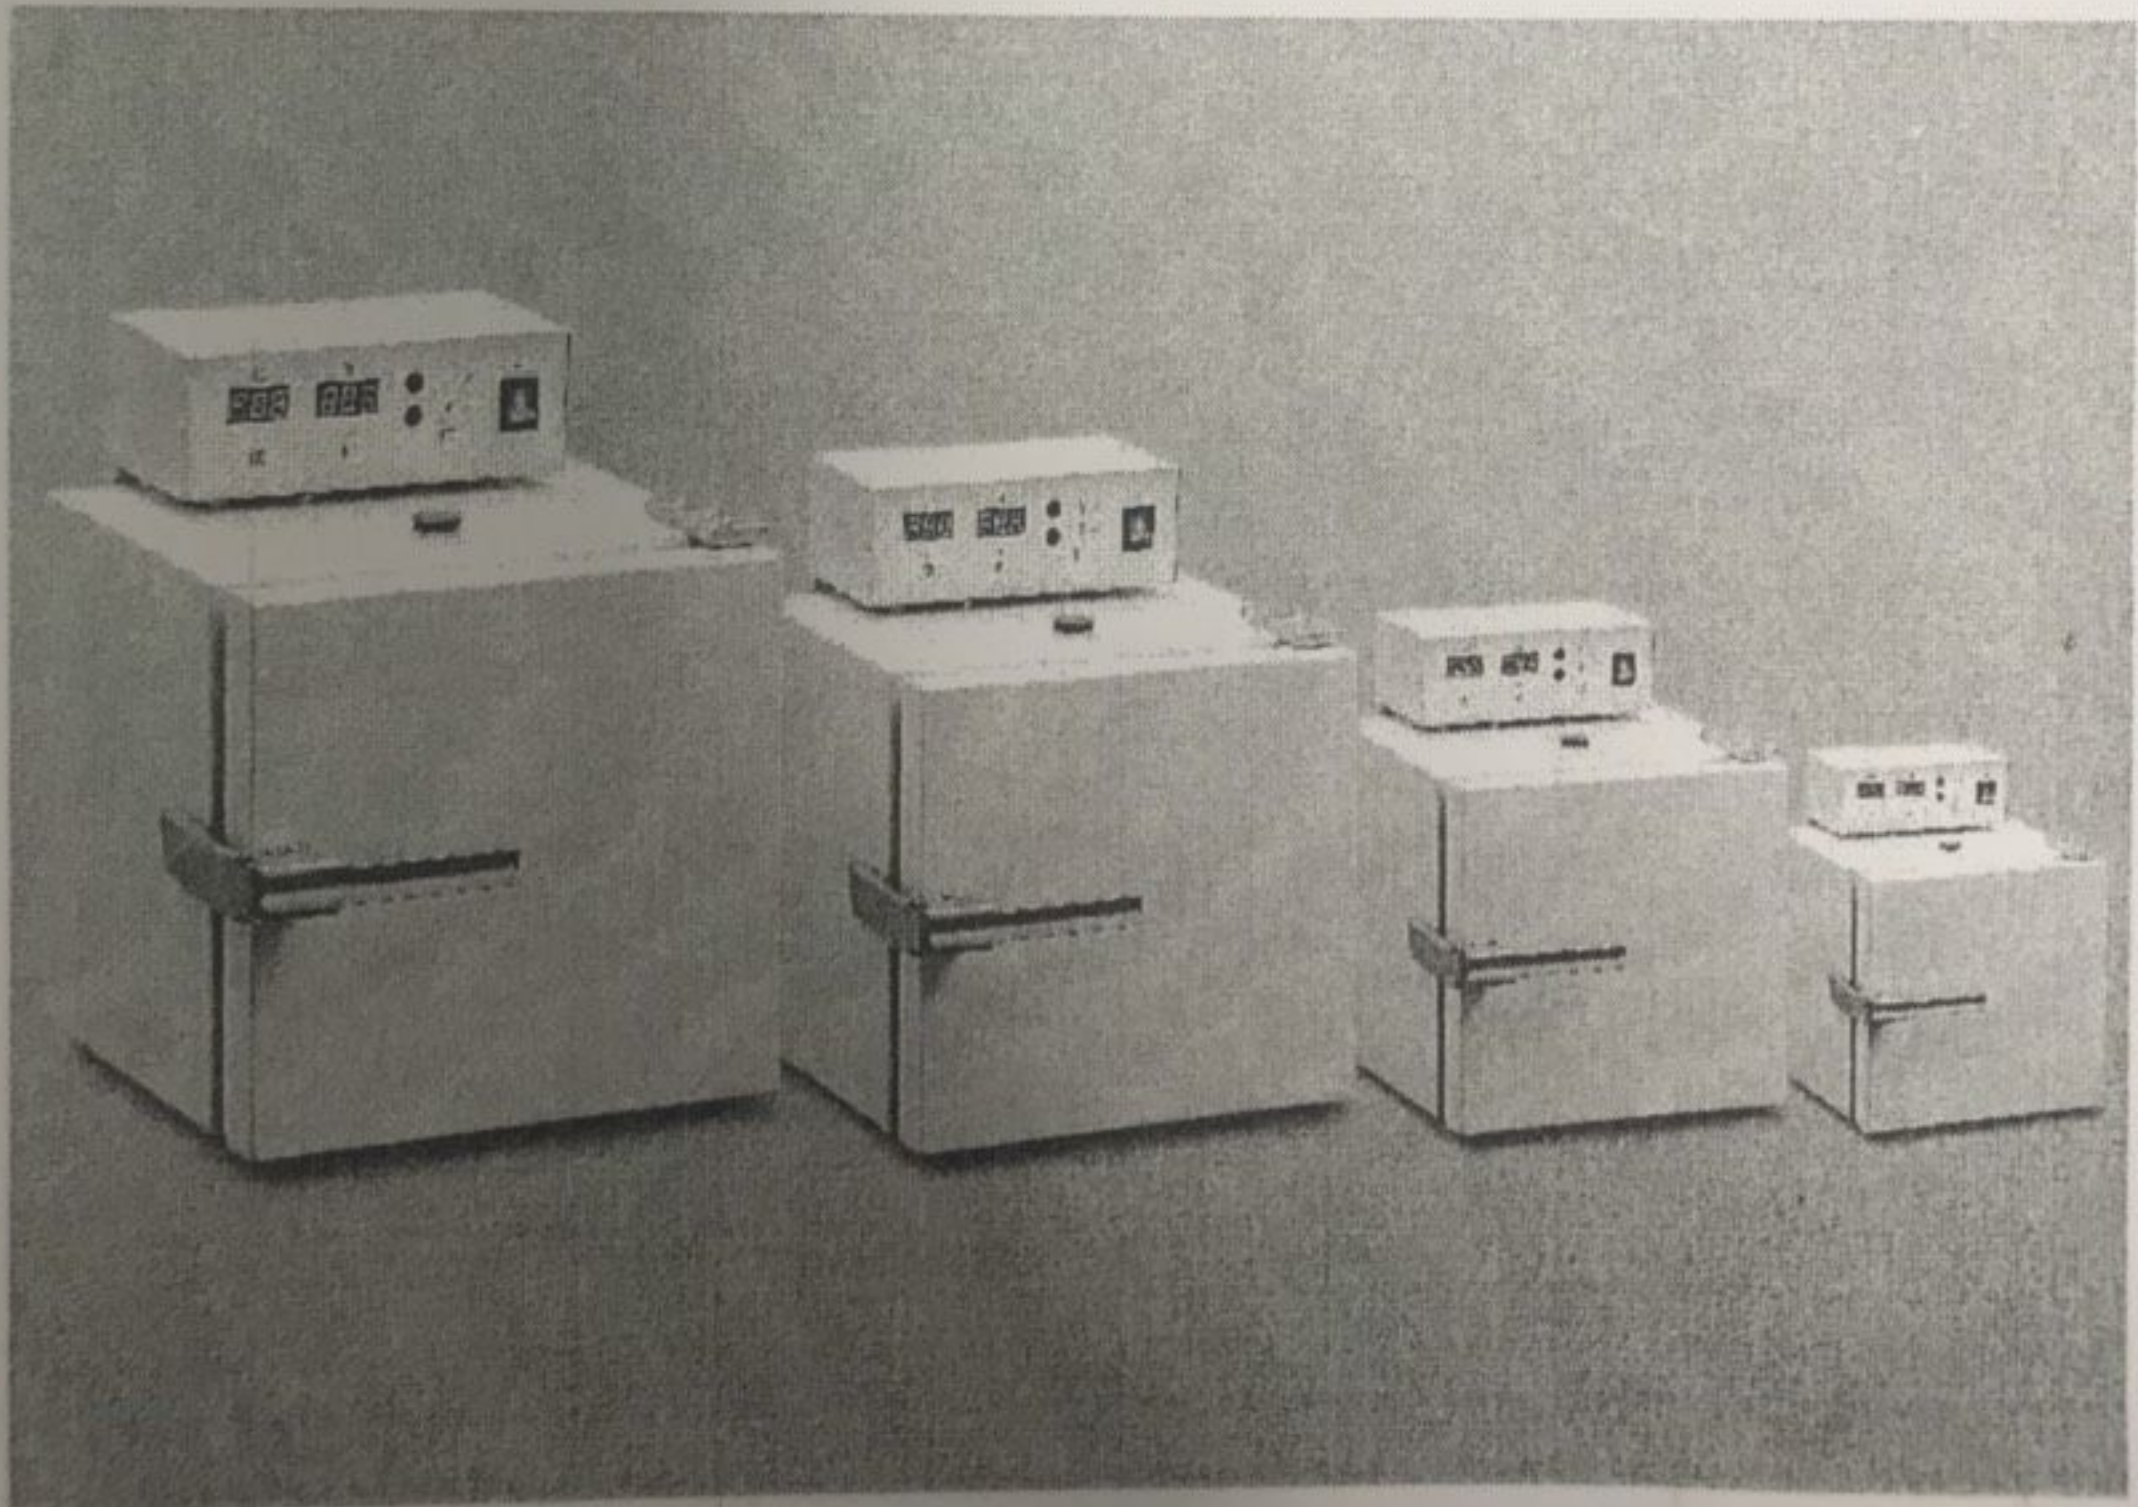


15. Свидетельство о приёме

Стерилизатор воздушный ГП-10-01, ГП-20-01, ГП-40-01, ГП-80-01
производственный номер 668
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документации
ТУ У 33.1-32132564-001-2003 и признан годным к эксплуатации.
Руководитель службы технического контроля выпуска _____
Дата выпуска 3 ИЮЛ 2018




16. Свидетельство о консервации

Стерилизатор воздушный ГП-10-01, ГП-20-01, ГП-40-01, ГП-80-01
производственный номер 668
подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренных в
технических условиях ТУ У 33.1-32132564-001-2003.
Дата консервации 3 ИЮЛ 2018
Изделие после консервации принял _____



17. Свидетельство об упаковке

Стерилизатор воздушный ГП-10-01, ГП-20-01, ГП-40-01, ГП-80-01
производственный номер 668
упакован согласно требованиям, предусмотренных конструкторской
документацией и ТУ У 33.1-32132564-001-2003.
Дата упаковки 3 ИЮЛ 2018
Изделие после упаковки принял _____



Код 409070

«Лизоформ Медікал»
 01133 м. Київ, вул. Євгена
 Конавальця, 31, кв. 314
 т./факс: (044) 233-16-72
 www.lysoform.net



Lysoform Medical LLC
 Evghena Konovaltsya Str.
 31, apart.314
 01133 Kiev
 tel/fax: (044) 233-16-72
 www.lysoform.net

в 28008101323947 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 Код за ЄДРПОУ 36257034

ТОВ «ЛИЗОФОРМ МЕДИКАЛ»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата 07.11.2018 р.

Назва продукції по НД Найменування продукції по НД	Бланідає Актив (BlanidasActive)	Номер партії (серії) Номер партини (серии)	1811076
Кількість продукції в серії, кг Колічність продукції в сериї, кг	4000	Дата випуску продукції Дата выпуска продукції	11.2018

Дослідження проведені по	TU Y 24.2-33147971-001:2008
Аналізи проведені по	TU Y 24.2-33147971-001:2008

№	Назва показників Наименование показателей	Вимоги нормативно-технічної документації Требования нормативно- технической документации	Результати досліджень Результаты анализов
1	Зовнішній вигляд, колір Внешний вид, цвет	Прозора рідина Прозрачная жидкость	Відповідає Соответствует
2	Запах	Характерний специфічний Характерный специфический	Відповідає Соответствует
3	Показник концентрації водневих іонів (рН 1%- го розчину засобу), одиниць рН Показатель концентрации водородных ионов рН (1%-го раствора средства), единицы рН	8,5 - 10,5	10,38
4	Густина при 20°С, г/см ³ Плотность при 20°С, г/см ³	0,900 - 1,100	0,965
5	Масова частка ЧАС (четвертинних амонійних сполук), % Массовая доля ЧАС (четвертичных аммонийных соединений), %	15,0 - 20,0	20,0
6	Упаковка Упаковка	Відповідно НД Соответственно НД	Відповідає Соответствует
7	Маркування Маркировка	Відповідно НД Соответственно НД	Відповідає Соответствует
8	Умови зберігання Условия хранения	при температурі від 0°С до +40°С при температуре от 0°С до +40°С	-
9	Термін придатності Срок годности	36 місяців 36 месяцев	36 місяців 36 месяцев

Висновок: препарат відповідає вимогам TU Y 24.2-33147971-001:2008

Заключення: препарат соответствует требованиям TU Y 24.2-33147971-001:2008

Примітка: документи відповідності (Свідчення про державну реєстрацію дезинфекційного засобу, Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи та Методичні вказівки щодо застосування дезинфекційного засобу) додаються до товаросупровідних документів

Примечание: документы соответствия (Свидетельство о государственной регистрации дезинфекционного средства, Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы и Методические указания по применению дезинфекционного средства) прилагаются к товаросопроводительным документам



Начальник ВКЯ

Handwritten signature

Головенко Я.О.